


液体ミルクすこやかM1 専用アタッチメント

取扱説明書

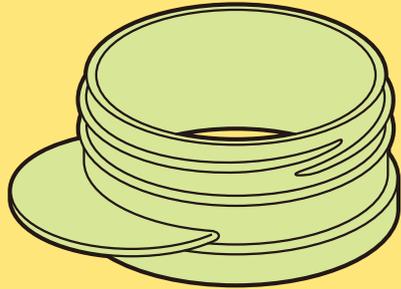

雪印ビーンスターク株式会社

札幌市東区苗穂町6丁目1番1号

お気づきの点は

雪印ビーンスターク（株）お客様センターへ
0120-241-537
9～17時（土日祝・年末年始を除く）
<https://www.beanstalksnow.co.jp>

品名	液体ミルクすこやかM1専用アタッチメント
材質	ポリプロピレン
耐熱温度	140°C

はじめに

「液体ミルクすこやかM1専用アタッチメント」（以下「アタッチメント」）は「液体ミルクすこやかM1」（以下「すこやかM1」）の缶に直接取り付けて使用するものです。それ以外には使用しないでください。


ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、衛生的に正しくお使いください。

●このマークがついた注意書きは、必ずお守りください。

	危険なので、してはいけないことです。
	安全のために、しなければならないことです。

「アタッチメント」を使うには

「液体ミルクすこやかM1専用アタッチメント」を使うときは、次の部品が必要です。組み立てる前に、それぞれの部品に異常がないかを確認してください。

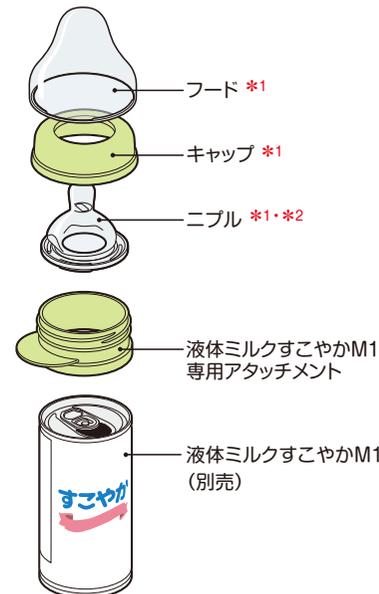

*1 「ビーンスターク哺乳びん 赤ちゃん思い 広口トライタンボトル」(240mL・150mL) (以下「赤ちゃん思い 広口トライタンボトル」) に付属しています。別途お買い求めください。

*2 別売りの「ビーンスタークニブル 赤ちゃん広口タイプ」もお使いいただけます。「フード」、「ニブル」、「キャップ」のお取り扱いには「赤ちゃん思い 広口トライタンボトル」のパッケージをお読みください。

使用上のご注意



- 「アタッチメント」が変形している、割れている、かけているなど、「アタッチメント」に異常があるときは、ミルクが漏れる、手や口にケガをするなど、思わぬ事故につながる場合がありますので使用しないでください。
- 取り付けがゆるくなったときや、きつくなったときは、ミルクが漏れる、「アタッチメント」が壊れるなど、思わぬ事故につながる場合がありますので使用しないでください。
- 天面が変形している「すこやかM1」に、「アタッチメント」を取り付けて使用しないでください。
- 火のそばに置くこと、5分を超えて煮沸すること、強い衝撃を与えることはしないでください。変形したり、破損することがあります。
- 「アタッチメント」を「すこやかM1」に取り付けたあと、落下させる、硬いものにぶつけるなど、衝撃をあたえないでください。「アタッチメント」や「すこやかM1」が変形したり、外れることがあります。
- 「すこやかM1」に、「ニブル」、「キャップ」、「フード」および「アタッチメント」をセットしたまま持ち運ばないでください。「アタッチメント」や「すこやかM1」が変形したり、外れることがあります。



- 「アタッチメント」を持つときは、必ず手や指を清潔にしてください。また、「アタッチメント」を使用する前は、「ニブル」、「キャップ」、「フード」、「すこやかM1」の天面（プルタブを含む）を清潔にしてください。
- 必ずお子さまを抱っこして、目を見ながら授乳してください。
- お子さまに「すこやかM1」を持たせ、ひとりで飲ませないでください。
- 「アタッチメント」を外出先に持ち運ぶときは、洗浄、消毒したあと、乾かしてから清潔な袋に入れるなどして衛生的に持ち運んでください。
- 「アタッチメント」を取り外すときは、爪や指をケガしないように、本書の「アタッチメント」の外しかた”をよくお読みください。
- 高温を避け、常温で保管してください。
- お子さまの手の届かない所に保管してください。


安心して授乳するには、「アタッチメント」、「ニブル」、「キャップ」、「フード」を清潔にしておくことが大切です。授乳の前には、手や指もよく洗い、清潔にしてください。

1 「アタッチメント」、「ニブル」、「キャップ」、「フード」を洗浄・消毒する。

- 「アタッチメント」は、下記の「洗浄・消毒のしかた」に従って、洗浄・消毒してください。
- 「ニブル」、「キャップ」、「フード」については、「赤ちゃん思い 広口トライタンボトル」のパッケージ、「洗浄・消毒について」に従って洗浄・消毒してください。

2 「すこやかM1」の天面を洗う。

- ブルタブの周りを清潔な水で洗い流してください。
- 洗い流した後の水滴は、清潔なタオル等で拭き取ってください。
- 洗い流すことができないときは、ウェットティッシュなどで、よく拭いてください。

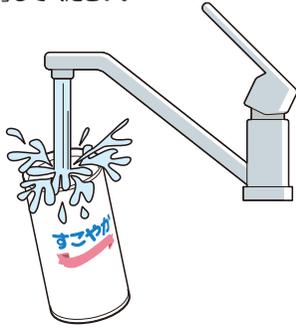

3 「すこやかM1」を振る。

- 中身が攪拌されるように3~5回振ってください。

洗浄・消毒のしかた

■ 洗浄のしかた

家庭用食器洗剤で洗浄してください。

■ 消毒のしかた

アタッチメントを清潔にお使いいただくために、使用する前には必ず消毒をしてください。

煮沸	薬液	電子レンジ
○	○	○

- 電子レンジで消毒するときは、必ず電子レンジ消毒用の専用容器を使用してください。「アタッチメント」をそのまま電子レンジにいれて消毒することはできません。

- 洗浄した「アタッチメント」が浸かる程度の水に入れ3~5分間煮沸してください。(水が少なかったり煮沸時間が長いと「アタッチメント」が早く傷みます。)

- 煮沸するときは、熱湯で火傷をしないように注意してください。
- 薬液は哺乳器専用の消毒薬を使用してください。詳細は消毒薬の説明書をお読みください。


ご使用前に「ニブル」、「キャップ」、「フード」および「アタッチメント」に変形などの異常がないことを確認してください。

1 「ニブル」、「キャップ」、「フード」をセットする。



2 1を「アタッチメント」に取り付ける。

- キャップが回らなくなるまでしっかり締めてください。

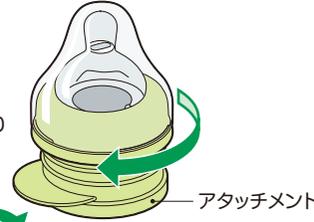


3 「すこやかM1」のブルタブを開ける。



4 「アタッチメント」を「すこやかM1」に取り付ける。

- 「ニブル」の平らな面と「すこやかM1」の飲み口を下向きの向きに合わせて取り付けてください。授乳するときは「すこやかM1」の飲み口を下向きにすると、缶にミルクが残りません。

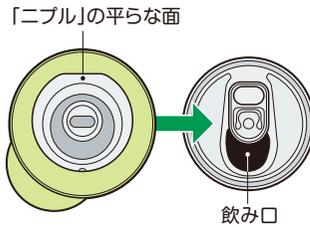


5 「アタッチメント」が正しく取り付けられているかを確認する。

- 「取り外し用ツメ」を下から軽く押し上げて外れないか?
- 正面、側面から見て水平になっているか?



1 アタッチメントを取り外す。

- 図のように「すこやかM1」と「アタッチメント」の間に指を入れて両手で持ち、「取り外し用ツメ」を下から押し上げてください。



2 「アタッチメント」、「ニブル」、「キャップ」、「フード」を分解し、洗浄する。


- 「アタッチメント」、「ニブル」、「キャップ」、「フード」を分解してください。
- 「アタッチメント」は、左記の「洗浄・消毒のしかた」に従って洗浄してください。
- 「ニブル」、「キャップ」、「フード」については、「赤ちゃん思い 広口トライタンボトル」のパッケージ、「洗浄・消毒について」に従って洗浄してください。

- 「すこやかM1」と「アタッチメント」の間に指を入れて、取り外そうとすると爪がひっかかりケガをすることがあります。必ず「取り外し用ツメ」を下から押し上げて取り外してください。

授乳のしかた

必ずお子さまを抱っこして、目を見ながら授乳してください。また、「ニブル」、「キャップ」、「アタッチメント」と「すこやかM1」の間からミルクが漏れていないことを確かめながら授乳してください。詳しくは「赤ちゃん思い 広口トライタンボトル」のパッケージをお読みください。

「ニブル」の平らな面を上にして授乳する。

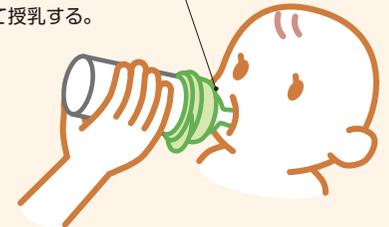

- お子さまに「すこやかM1」を持たせ、ひとりで飲ませないでください。